



### INTRODUCTION



Cartographie des risques de notre stérilisation :  
Recomposition = étape la plus critique



Mise en place d'un double contrôle aléatoire de la reconstitution

**OBJECTIFS** : - détection des erreurs lors de la reconstitution et sensibilisation du personnel  
- mise à jour de la base de données du logiciel de traçabilité OPTIM SPM®

### MATÉRIEL ET MÉTHODE


- Écriture d'une procédure et élaboration d'une grille d'audit :

	Conforme	Non conforme	Non évaluable
1 - Aspect global de la composition (cupules au-dessus, plateau rangé)			
2 - La photo globale est présente			
3 - La photo de chaque article est présente*			
4 - Les DM fragiles sont protégés (tapis silicone, emplacement dédié, etc.)*			
5 - Les DM piquants/tranchants sont protégés à leur extrémité*			
6 - Les DM sont propres et secs*			
7 - Les DM présents physiquement dans la compo correspondent aux libellés inscrits dans OPTIM SPM®*			
8 - Les références des DM présents dans la compo sont celles notées sur OPTIM SPM®*			
9 - Les tailles des DM notées sur la composition OPTIM SPM® sont respectées dans le plateau (écart de ± 1 cm maximum)*			
10 - Les DM à remonter sont remontés*			
11 - Les DM présents dans la composition sont fonctionnels*			
12 - Si un DM est manquant, l'étiquette de NC est présente*			
13 - Conditionnement : si le plateau est emballé, vérifier le système d'emballage			
14 - Conteneurs : vérification d'usage			

\*Nombre de NC à préciser

- Évaluations réalisées par les pharmaciens, internes et PPH chefs de production de plateaux sélectionnés de manière aléatoire après leur reconstitution

### RÉSULTATS

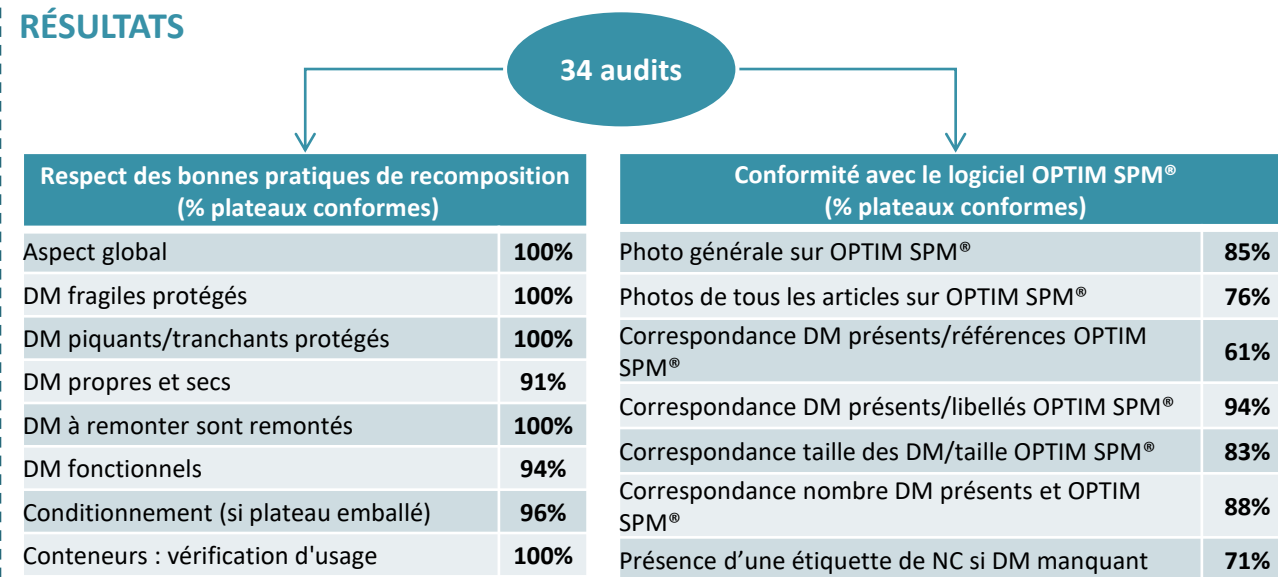

### DISCUSSION ET CONCLUSION

- Non-conformités les plus fréquentes : critères en lien avec le logiciel de traçabilité OPTIM SPM®
  - Mise à jour de la base de données du logiciel
- Erreurs identifiées, certaines potentiellement graves (ex : instrument endommagé non détecté)
  - Toute erreur détectée est signalée à l'agent ayant effectué la reconstitution du plateau
  - Reprise des erreurs les plus graves en réunion hebdomadaire avec l'ensemble de l'équipe

➡ **Nouvel indicateur qualité**