

1. Introduction

La pré-désinfection = 1er traitement à effectuer sur les dispositifs médicaux réutilisables (DMR) :

Eviter le séchage des souillures / faciliter le nettoyage ultérieur / protéger le personnel et l'environnement.

Signalement d'importants écarts de pratiques dans une unité de soin.

Objectif : Evaluation de cette étape clé du processus de stérilisation dans l'ensemble des services utilisant les DMRs

2. Méthode

24 services concernés/évalués

Elaboration grille auto-évaluation Pharmacie / hygiène

Evaluation des pratiques au regard de la **procédure institutionnelle**

Audit observationnel Secteurs non répondeurs ou présentant des non-conformités(NC) majeures

Grille évaluation

10 questions sur 4 thématiques :

1. Tenue professionnelle
2. Matériel utilisé et entretien (bas et brosse)
3. Préparation du bain
4. Utilisation du bain.

AVANT DES CONDITIONS DE PRÉ-DÉSINFECTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM) STÉRILES RÉUTILISÉS DANS LES UNITÉS DE SOINS

De questionnaire à remplir en conditions de pré-désinfection des DM réutilisables dans le cadre d'un audit qualité de service de stérilisation. La durée estimée de remplissage de ce questionnaire est de 10 min.

Service de soins : O.R.L. A.S. A.S.A.G. Auxiliaire de puériculture Autre : _____

Date : _____

Totaux des questions effectuées : 0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10

1. Tenue professionnelle

Questions	Items de réponse	OUI	NON	COMMENTAIRES
Porter de protection à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Masque avec cache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Longue de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Chaussures à semelles souples à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Savon moussant à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Masque type chirurgical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. Matériel

Questions	Items de réponse	OUI	NON	COMMENTAIRES
Bas propres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Équipement de protection individuelle (EPI) adaptés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. Le bain de pré-désinfection

Questions	Items de réponse	OUI	NON	COMMENTAIRES
Volume de bain pré-désinfectant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Volume d'eau égale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Temps de contact	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Température	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. Entretien du bain et du matériel

Questions	Items de réponse	OUI	NON	COMMENTAIRES
Préparation du bain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Utilisation du bain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


5. Tenue professionnelle

Questions	Items de réponse	OUI	NON	COMMENTAIRES
Porter de protection à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Masque avec cache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Longue de protection	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Chaussures à semelles souples à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Savon moussant à usage unique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Masque type chirurgical	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autre : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	


3. Résultats

CONFORMITÉ GLOBALE

■ Conforme ■ Non conforme



% de conformité par thématique

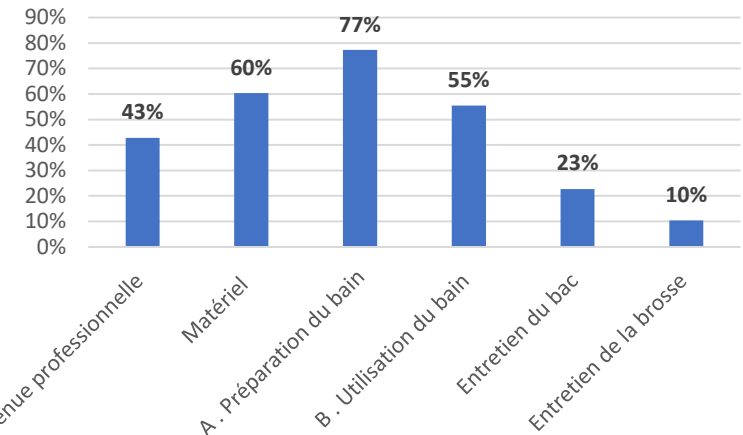

4. Discussion/Conclusion

NC majeures recensées

1 Usage de détergent désinfectant (DD) – produit ou dilution → **Finalemnt conforme** (méconnaissance de la dénomination du produit)



2 Absence de brossage (+/- de brosse) et de port d'équipements de protection individuel (EPI) adaptés → Assurance de certains soignants de ne pas s'exposer à un risque chimique ou biologique
- Préconception d'un brossage superflu devant un DMR visuellement propre



Mesures correctives

1. Restitution globale en réunion relais hygiène



- Diffusion procédure
- Mise à disposition des EPI manquants



Sensibilisation personnalisée auprès de chaque cadre

2. Nouvelle évaluation planifier à M + 6-8